物品修理要求書

総務部長 決裁印		調達要求番号	教修 4	科目	項	防衛力基盤整備費
					目	教育訓練費
					細分	備品修理費（教訓・雑役務費）

要求欄

平成　年　月　日

会計課					関係課（室）	要求元				
課長	室長	補佐	係長	係		分任物品管理官	課長等	補佐	供用官	係

分類番号				品名	規格	単位	数量	単価	金額
中	小	細	品						
32	06	08	013	磁化特性測定装置修理	仕様書のとおり	式	1		

明細説明	

分類	防衛用品（防）	総額	納期	平成　年　月　日
物品整理区分	消耗品		納入場所	防衛大学校

備考					
課室名	応用化学科	要求者氏名	小泉　俊雄	電話番号	内線 3582

調達欄

室長	補佐	係長	係

契約方式	一般 指名 随意	根拠法令	会計法第29の3第　項 予決令第　条第　項第　号

選定業者		契約条件	

予定価格	総額	算出の基礎
	円	

調達説明日時	平成　年　月　日　時　分
入札日時	平成　年　月　日　時　分

仕　様　書		調達要求番号	教修 4
品　　名	数　量	備　　考	
磁化特性測定装置修理	1　式	日本電子　JNM-AL300　BOKO	

1　総則

（1）適用範囲

本仕様書は、防衛大学校応用化学科で保有する磁化特性測定装置の修理について適用する。

2　修理に関する要求

（1）修理対象器材

本修理の対象器材及び設置場所等は表による。

表

No.	品名	数量	型式	設置場所
1	磁化特性測定装置	1	日本電子　JNM-AL300　BOKO	応用有機化学実験棟1F

（2）修理内容

本器材のｺﾝﾌﾟﾚｯｻが故障及びｴｱｰ流路系統が動作不良の状態となっているため、不良部品の交換後、器材の総合的な動作確認及び調整を行う。

（3）交換部品

C/H OSC 300	NM163610-0010用	×	1式
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	74R630P176H301	×	1個
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	74R130P-101H200	×	1個
ｽﾅｯﾌﾟﾄﾗｯﾌﾟ	NH-503J2L (LOW)	×	1個
ｺｰﾄﾞ付ﾌｧﾝ	CN55B2 AC100V	×	9個
ｴｱｰﾌｨﾙﾀ	F3000-8-W-F1	×	2個
ｽﾋﾟﾝﾅｰﾛｰﾀｾｯﾄ	824991770	×	1式

詳細は付図を参照とする。

別途、交換部品が発生した場合、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

（4）消耗品等

修理に必要な消耗品等は契約相手方が準備するものとする。

（5）修理場所

防衛大学校応用有機化学実験棟1Ｆ

3　検　　査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

4　そ の 他

（1）作業後の不用となった交換部品及び廃材（契約相手方が持ち込んだ梱包材等を除く）については、発生材調書を添えて契約担当官等の指示する場所に集積するものとする。

（2）契約相手方は、作業終了後速やかに作業報告書２部を提出するものとする。

（3）仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

（4）本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

C/H OSC 300

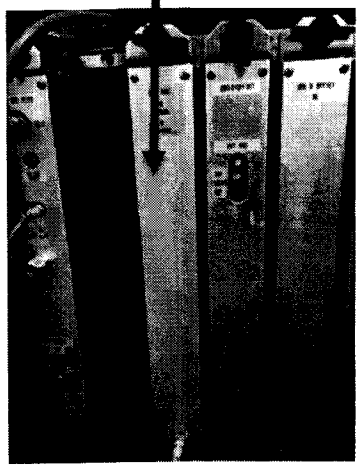

コンプレッサ

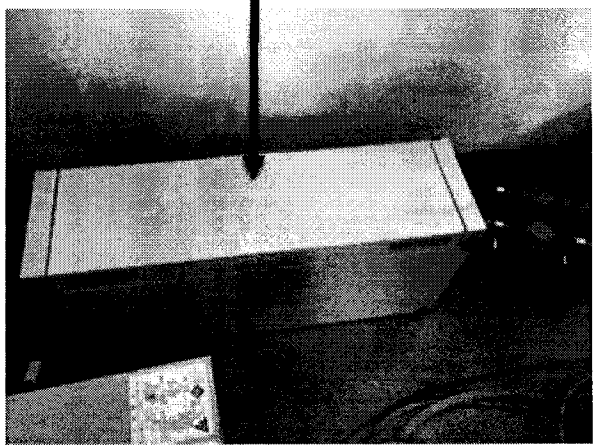

スピンナーロータ

スナップトラップ

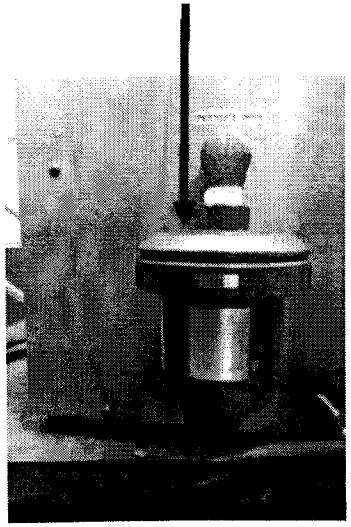
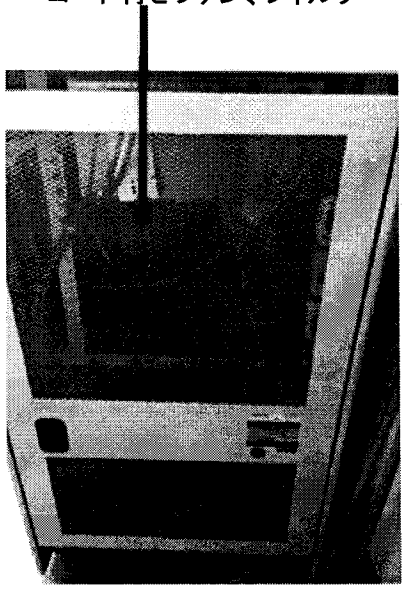
コード付きファン、フィルター